


Catlink Pro Ultra

Besonderheiten: KI-Gesundheitsmonitor mit Kamera (Gewichtskontrolle, Erkennung von weichem Kot oder Blut im Stuhl), 2-Wege-Audio, 5-fach Geruchskontrolle, Mehrkatzen-Erkennung, App (Füllstand der Katzentoilette, Nutzungsdaten, Reinigungserinnerungen), Push-Nachrichten mit Bild

Preis: ca. 600.- €

Bestellung: catlink.eu.com

So schön wie die Katzen auf dem Bild des Herstellers ließen sich unsere Katzen nicht ablichten – begeistert waren sie trotzdem

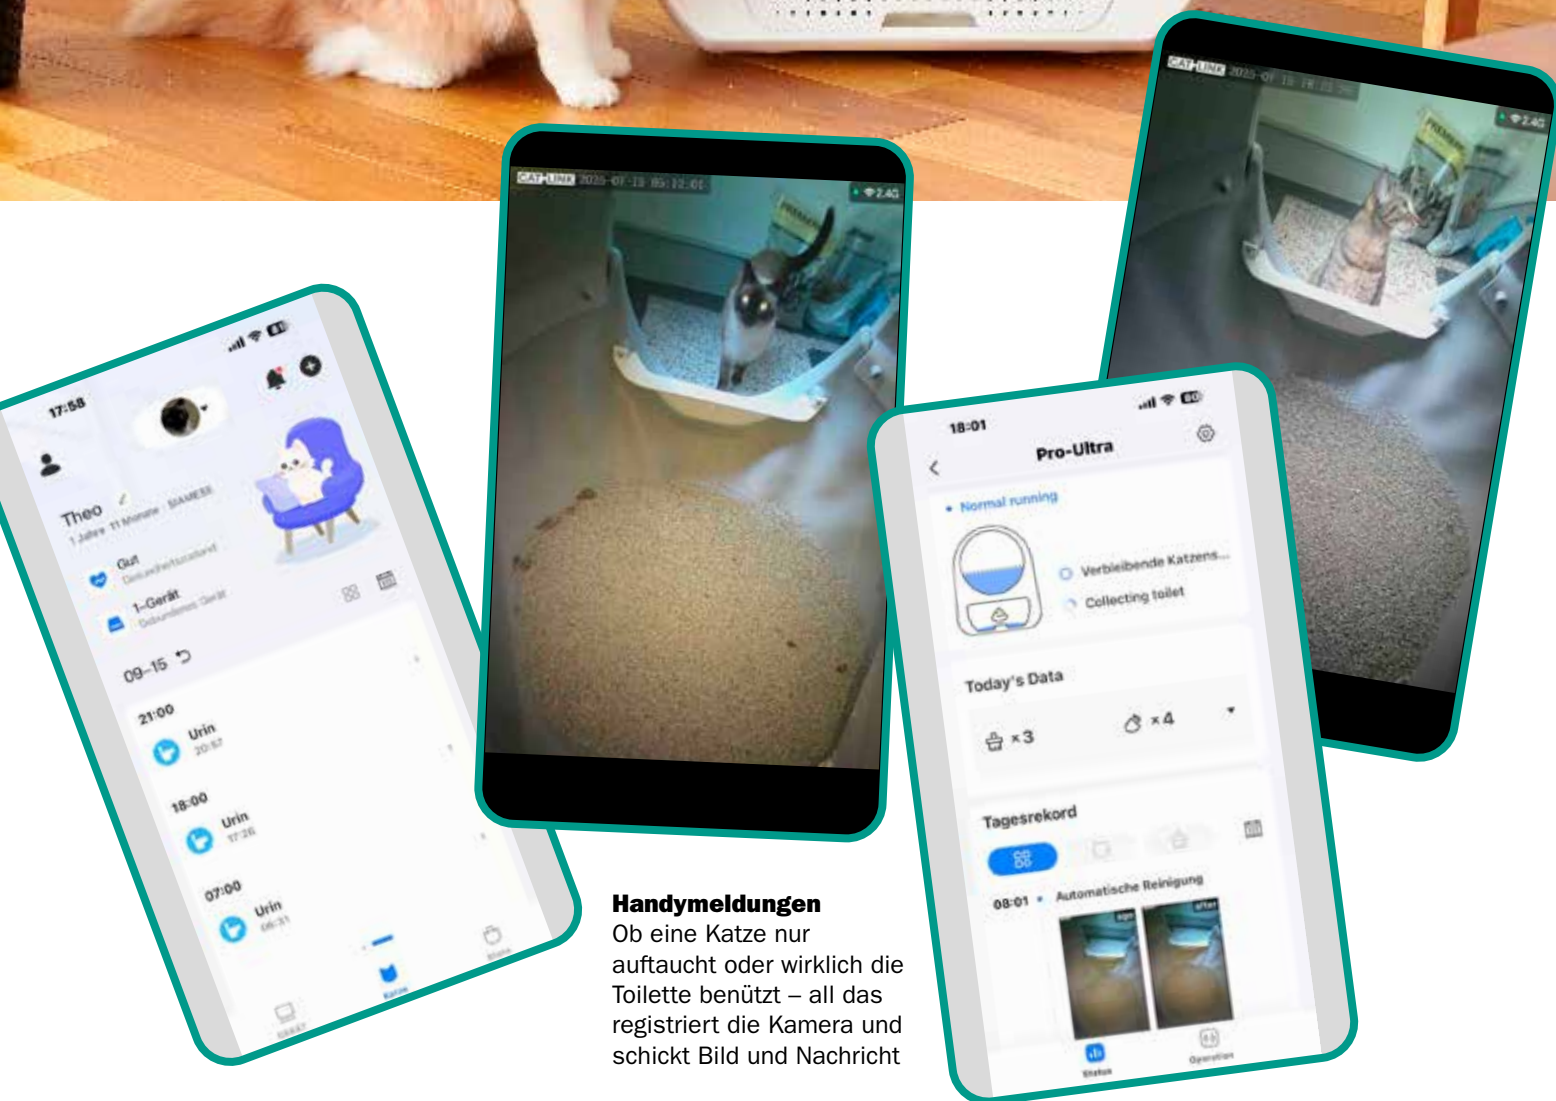

Handymeldungen

Ob eine Katze nur auftaucht oder wirklich die Toilette benützt – all das registriert die Kamera und schickt Bild und Nachricht

Hightech-Katzentoilette im Test

Die Redaktionskater Willy und Theo testeten die „Catlink Pro Ultra“. Und sind sich einig wie sonst nur bei Leckerlis: Eine klare Empfehlung! Die Besitzerfamilie schließt sich an – und freut sich über Photos und Nachrichten der Toilette auf dem Handy

KATRIN TEMPEL

Seit acht Jahren haben wir in unserer Familie Katzen, seit acht Jahren haben wir fast täglich Streit. Der Grund: Um eine Katze zu bekommen, versprach unsere Tochter mit großen Augen, dass sie sich um das Katzenklo kümmern würde. Und das tut sie. Oder auch nicht. Die Tochter wurde größer, aus einem Kater wurden zwei – der Streit blieb. Würde eine selbstreinigende Katzentoilette den Familienstreit beenden? Und gleichzeitig die beiden Kater glücklich machen? Wir haben das selbstreinigende Katzenklo Catlink Pro Ultra zusammen mit Willy (Tigerkater aus dem Tierschutz, 5 Jahre alt) und Theo (Thaikater vom Züchter, 2) getestet.

Vom Skeptiker zum eifrigen Dauernutzer

Der Test startete mit einem riesigen Paket, das nur knapp durch die Haustüre passte. Darin die Katzentoilette, die ein bisschen an eine weiße Waschmaschine erinnert. Und gleich die erste Überraschung: Wir mussten fast nichts zusammenbauen, die Toilette war innerhalb weniger Minuten bereit. Dazu die App herunterladen, die Profile der beiden Kater hinterlegen – fertig.

Wir haben die konventionelle Katzentoilette neben dem neuen Hightech-Gerät stehenlassen. So wollten wir vermeiden, dass unsere

Kater von der Technik überfordert unsauber werden. Kurz darauf kamen die ersten Meldungen mit Bild auf unsere Handys. „Cat has appeared – Katze nähert sich“. Deutsch kann Catlink bis jetzt nur auf der App, nicht in den Push-Nachrichten. Zwei Tage lang sahen die beiden sich die Toilette an. Dann war es soweit: Theo wagte sich hinein. Mit Erfolg „Cat peed“. 5 Minuten nach dem Verlassen der Toilette dreht sich die Trommel, der Katzensand ist wieder sauber. Die Hinterlassenschaften sammeln sich in einem Schubfach unter dem Eingang in einem Plastikbeutel. Und wenn der voll ist, meldet sich die App.

Theo wurde ab sofort zum Dauernutzer der Toilette. Und unsere Handys vermeldeten Uhrzeit, Art und Gewicht von Katze und Hinterlassenschaft. Nachts geht sogar das Licht in der Toilette an, damit wir (und die Kamera) sehen können, wer zu Besuch war. Ein Zusatzgadget: Es gibt auch Mikrofon und Lautsprecher. Und ist allerdings bis heute nicht klar, warum wir mit unseren Katzen sprechen sollten, während sie ihr Geschäft verrichten.

Catlink Pro Ultra wiegt, warnt und schickt Bilder

Unser Willy blieb skeptisch. Sah sich das Gerät immer wieder an und verschwand. Erst nach einer Woche



Klare Empfehlung der Redaktionskater Willy (im Bild) und Theo



wagte er sich in den Sand. Und nutzte ab sofort nie wieder die konventionelle Toilette. Ein paar Tage später hatte die KI gelernt, die beiden durch Gewicht und Bild auseinanderzuhalten. Jetzt lauten die Meldungen anders: „Willy peed – Willy hat gepinkelt“ oder „Theo pooped – Theo hat gekotet“. In der App lässt sich sogar die Menge nachsehen.

Toller Zusatznutzen: Als Theo einen Tag lang unterwegs war, warnte die App: „Theo war seit 24 Stunden nicht pinkeln. Gehe zum Tierarzt!“ Im Urlaub bekamen wir mehr Bilder von den Katern als sonst vom Katzensitter. Und der Familienfrieden? Der ist jetzt gesichert. Bis (etwa alle 10-14 Tage) die Meldung kommt, dass der Beutel ausgetauscht werden muss ... 🐾

Fotos: Hersteller, privat